



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.6/T P.1. 2024

Otwock, dnia 27.02.2024

Do wszystkich
zainteresowanych

Nr referencyjny Nr sprawy: 6/ TP/2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn Dostawy odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu , który automatyzuje procedury barwienia metodami IHC i ISH.

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

1. Dotyczy Załącznik nr 3:

Zwracamy się z prośbą o możliwość dodania w formularzu tabeli w celu wyspecyfikowania materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak ,Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w formularzu ofertowym tabeli na wyspecyfikowanie materiałów eksploatacyjnych .

2. Dotyczy Załącznik nr 3:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w poz.9 nastąpiła oczywista omyłka pisarska, nazwa powinna brzmieć "Calretynin"

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska winno być : "Calretynin"

3. Dotyczy Załącznik nr 3, poz. 6, poz.32:

W ofercie posiadamy CD45 klon RP2/18 oraz klon 2B11, PD7/26.

W związku z tym zwracamy się prośbą o wskazanie rodzaju klonu dla poz. 6 oraz dla poz. 32.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje : dla poz. 6 oraz dla poz.- 32 klon 2B11, PD7/26.

4. Dotyczy Załącznik nr 3, poz. 27:

W ofercie posiadamy E-cadherin klon EP700Y (50 testów) oraz klon 36 (50 testów).

Zwracamy się z prośbą o wskazanie, którego z nich wymaga Zamawiający w poz. 27.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje : w poz. 27 - klon EP700Y

PYTANIA DO UMOWY:..

5. par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy dostawy wraz z dzierżawą aparatów na załączonym wzorze?

W przypadku braku zgody zwracamy się z prośbą o przedstawienie wzoru umowy dzierżawy oraz udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące umowy dostawy.

6. par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

7. par. 13 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy i dokonuje modyfikacji poprzez załączenie wzoru umowy dostawy wraz z dzierżawą aparatu

8. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH, Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.


Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin ważności odczynników wynosił 9 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczytnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS

. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

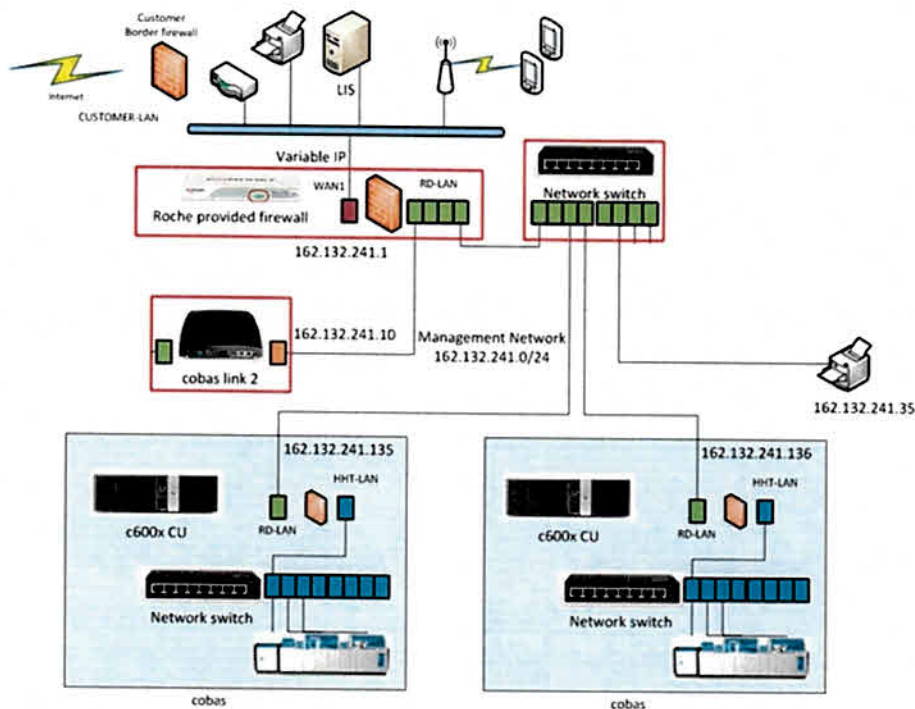

Odpowiedź Zamawiającego : Tak dla aparatu .

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka

p.o. DYREKTORA NACZELNEGO
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruzlicy

Anna Kamińska

